



KANE79L





Détecteur/enregistreur
de monoxyde de carbone et
protection individuelle contre le CO



Octobre 2024

SOMMAIRE

Page No.

| | | |
|----------|---|--------------|
| 1 | VUE D'ENSEMBLE ET AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ | 4-5 |
| 1.1 | ENREGISTREMENT DES DONNÉES | 4 |
| 1.2 | KANE  LINK | 4 |
| 1.3 | AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ | 5 |
| 2 | CARACTERISTISUQUES ET UTILISATION DU CLAVIER | 6 |
| 3 | INSTRUCTIONS D'UTILISATION | 7-8 |
| 4 | MESURE DU CO | 9 |
| 5 | CONFIGURER LE KANE79 POUR ENREGISTRER, VISUALISER ET TRANSFÉRER LES SAUVEGARDES | 10-19 |
| 5.1 | MODES SANS FIL - DÉSACTIVER, LIAISON ET APPLICATION | 10 |
| 5.2 | CONNEXION À KANE LIVE | 11 |
| 5.3 | AFFICHER ET ENREGISTRER LES LECTURES | 12 |
| 5.4 | DÉMARRER L'ENREGISTREMENT IMMÉDIAT | 13 |
| 5.5 | DÉMARRER L'ENREGISTREMENT PROGRAMME | 14 |
| 5.6 | ARRETER L'ENREGISTREMENT PROGRAMME | 15 |
| 5.7 | VISUALISER L'ETAT DE LA SAUVEGARDE EN COURS | 16 |
| 5.8 | ARRETER LA SAUVEGARDE EN COURS | 17 |
| 5.9 | TELECHARGER LES DONNEES SAUVEGARDEES | 18 |
| 5.10 | SUPPRIMER LES DONNEES SAUVEGARDEES | 19 |
| 6 | UTILISER KANE  LINK POUR SE CONNECTER A L'ANALYSEUR | 20-21 |
| 7 | CONCENTRATION DE CO | 22 |
| 8 | ALARMES SONORES ET VIBRANTES | 23 |

| | | |
|-----------|-------------------------------------|--------------|
| 9 | ETAT DES BATTERIES | 23 |
| 10 | REPLACEMENT DES BATTERIES | 24 |
| 11 | DEPANNAGE | 25 |
| 12 | SPECIFICATIONS | 26 |
| 13 | NETTOYAGE | 27 |
| 14 | PRECAUTIONS PAR TEMPS FROID | 28 |
| 15 | OU ENVOYER VOTRE DETECTEUR | 28 |
| 16 | DECLARATION DE CONFORMITE EU | 29 |
| 17 | KANE SERENITE | 30-33 |
| 18 | KANE & UKAS | 34 |
| 19 | RECYCLAGE | 35 |
| 20 | REMERCIEMENT | 36 |

1

VUE D'ENSEMBLE ET AVERTISSEMENT DE SECURITE

Votre KANE79 mesure les niveaux de monoxyde de carbone (CO) dans toute zone intérieure où les gens travaillent, vivent ou voyagent.

Votre KANE79 est destiné à être utilisé dans tout environnement fermé normal.

Ne l'utilisez pas dans des zones appelées « espaces confinés » où d'autres gaz toxiques peuvent être présents ou dans des zones où la sécurité intrinsèque est obligatoire.

Votre KANE79 :

- Mesure le CO jusqu'à 999 ppm
- Enregistre jusqu'à 20 000 tests pour le transfert vers KANE LIVE
- Enregistre la valeur maximale
- Alarme prédéfinie et vibrante
- LED de couleur visuelle et signal sonore
- Conservation des données
- Indicateur de durée de vie de la batterie
- Capteur longue durée avec une durée de vie prévue de 5 ans

1.1

ENREGISTREMENT DES DONNEES

Votre KANE79 peut être configuré par notre application KANE LIVE pour enregistrer jusqu'à 20 000 tests - Voir section [5](#)

1.2

KANE LINK

Vous pouvez connecter sans fil jusqu'à 4 détecteurs de CO KANE79 à votre analyseur KANE LINK

Lorsqu'ils sont allumés, ils remplacent ou ajoutent des mesures à votre analyseur KANE LINK

Voir section [6](#) pour ajouter, gérer ou supprimer des appareils KANE LINK



AVERTISSEMENT DE SECURITE !



Le CO est mortel même à de faibles concentrations

Assurez-vous de comprendre le risque avant d'utiliser le produit

Ce détecteur mesure les gaz toxiques à des concentrations relativement faibles.

Allumez et mettez toujours le détecteur à zéro à l'air frais extérieur

Ce détecteur ne doit être utilisé que par des personnes formées et compétentes après avoir dûment pris en compte tous les dangers potentiels.

Vous devez effectuer un test de déclenchement avant d'utiliser le détecteur.

Un test de déclenchement est un moyen de vérifier qu'un détecteur fonctionne dans des limites acceptables en l'exposant brièvement à des mélanges de gaz connus qui modifient la sortie des capteurs présents.

REMARQUE : cela diffère de l'étalonnage où les détecteurs sont exposés à des mélanges de gaz connus mais laissés se stabiliser à une valeur stable avec des lectures ajustées au gaz de test.

Un test de déclenchement peut être effectué à l'aide d'une cartouche jetable de CO parfois utilisée pour vérifier les alarmes de CO domestiques.

CARACTERISTIQUES ET UTILSATION DU CLAVIER




Chaque pression sur un bouton émet un bip sonore



ATTENTION !

Toujours l'allumer à l'air frais extérieur loin des conduits de chaudière, du véhicule, des gaz d'échappement, barbecue, fumeurs et toute autre source potentielle de CO.

1. Allumez en appuyant sur le bouton marche/arrêt
2. Un compte à rebours démarre de 30

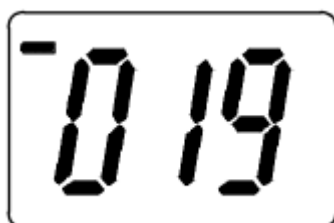

3. Affichage normal :




Le moniteur affiche le CO en ppm sur 3 digits

Indicateur de niveau de batterie dans le coin supérieur gauche

Unité du CO en ppm dans le coin inférieur droit

4. Affichage de la valeur max de CO mesuré




Appuyez sur MAX  pour afficher la mesure la plus élevée lorsque le détecteur est allumé.

Appuyez à nouveau pour revenir à la valeur actuelle.

La valeur maximale est réinitialisée lorsque le détecteur est éteint et rallumé.

“PAUSE” du CO mesuré

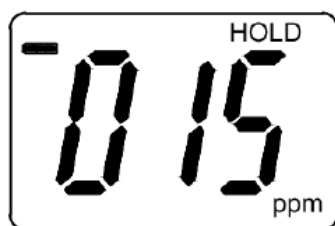

Appuyez sur  pour mettre en « PAUSE » l'affichage

Appuyez à nouveau pour revenir à la valeur actuelle

Le mode « PAUSE » est également réinitialisée lorsque le moniteur est éteint et rallumé

Appuyez sur On/Off  pendant 3 secondes pour éteindre

Remarque : assurez-vous que la protection de la cellule du détecteur est exempte de toute obstruction.

Le KANE79 est un détecteur d'air ambiant. Il ne remplace pas les tests nécessitant des sondes spécifiques pour tester les appareils.

N'exposez pas le détecteur à des températures ambiantes supérieures à 40 °C.

N'utilisez pas le détecteur pour mesurer directement les gaz de combustion.



ATTENTION !

Si les niveaux de CO dans une pièce ou un espace dépassent 20 ppm

1. Éteignez tous les appareils
2. Évacuez et aérez la pièce ou l'espace




5**CONFIGURER LE KANE79 POUR ENREGISTRER, VISUALISER ET TRANSFERER DES SAUVEGARDES****5.1****MODE SANS FIL – DESACTIVER, LIAISON ET**

Pour enregistrer les tests de CO, vous devez configurer votre KANE79 via l'application KANE LIVE.

Votre KANE79L s'allume avec les communications sans fil désactivées (c'est-à-dire en mode normal) pour prolonger la durée de vie de la batterie.

Changez de mode comme suit :

1. Appuyez et maintenez enfoncé MAX & HOLD pendant 2 secondes pour ouvrir le menu
2. Appuyez sur MAX (haut) ou HOLD (bas) pour voir les modes
3. Appuyez sur ON/OFF (ENTER) pour sélectionner le mode

| | |
|---|--|
|  | NORMAL – Toutes les communications sans fil sont désactivées. |
|  | LINK – Votre KANE79L envoie des mesures de CO en direct à un analyseur KANE LINK mais ne peut pas se connecter à l'application KANE LIVE. |
|  | APP – Votre KANE79L se connecte à KANE LIVE pour définir et démarrer l'enregistrement ou le partage de mesures en direct. |

REMARQUE : après 10 minutes d'inactivité, votre KANE79L passe en mode NORMAL pour prolonger la durée de vie de la batterie.

5.2 CONNEXION A KANE LIVE


REMARQUE : téléchargez l'application KANE LIVE sur votre smartphone ou tablette et activez le Bluetooth sur votre appareil.



Suivre 5.1 pour active KANE79 en MODE APP




Ouvrez KANE LIVE et appuyez sur CONNECTER

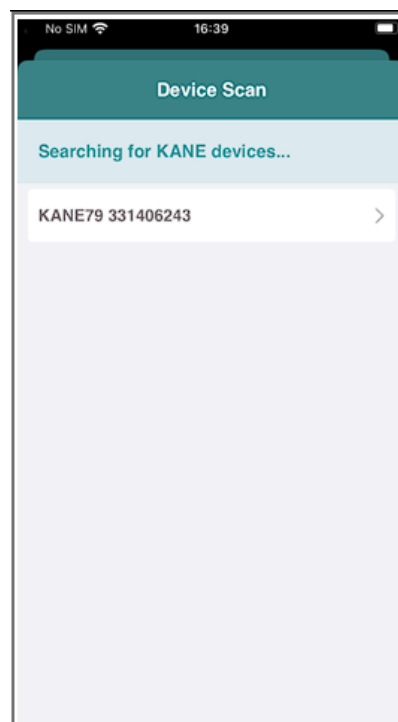

Localisez le KANE79 dans la liste des appareils et appuyez pour vous connecter




KANE LIVE se connecte

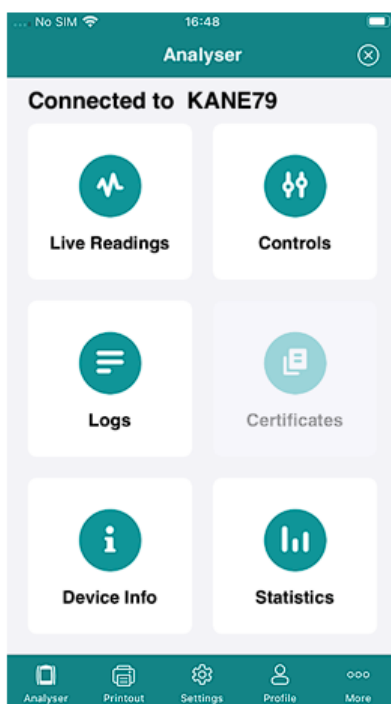


... et présente cet écran une fois connecté


5.3 AFFICHER ET ENREGISTRER

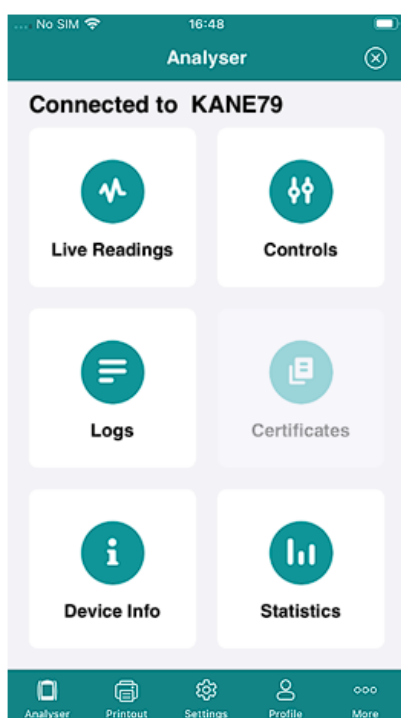


Appuyez sur Lectures en direct

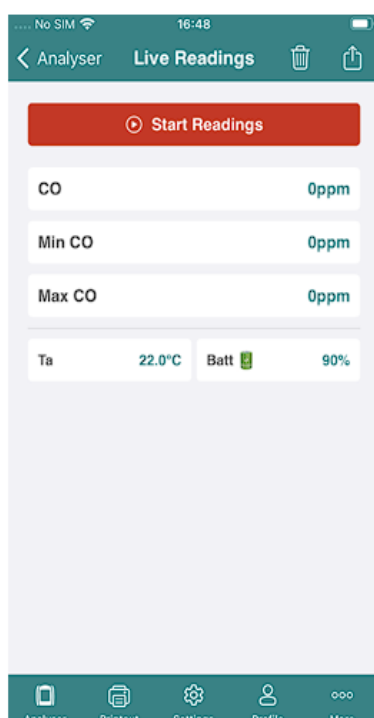


Pour enregistrer des lectures en direct, appuyez sur Démarrer les lectures

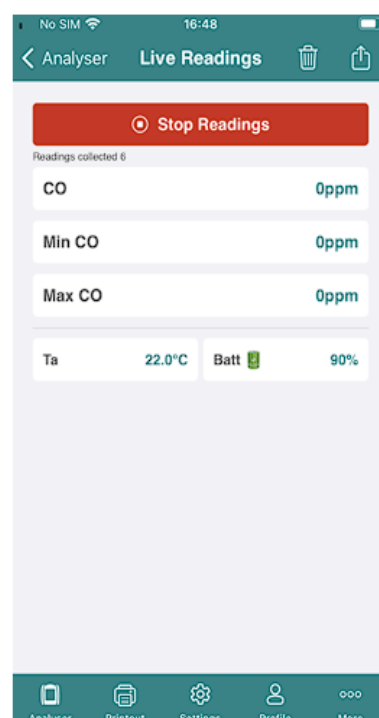

Arrêtez et redémarrez à tout moment

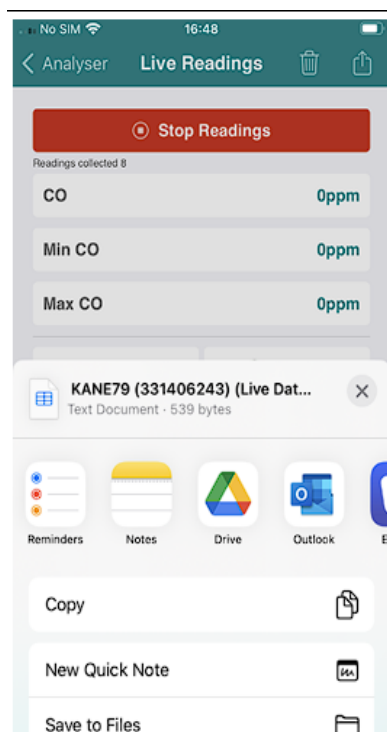

Pour enregistrer les lectures au format *.csv, appuyez sur l'icône de partage dans la barre d'en-tête de l'application et sélectionnez l'application ou l'action

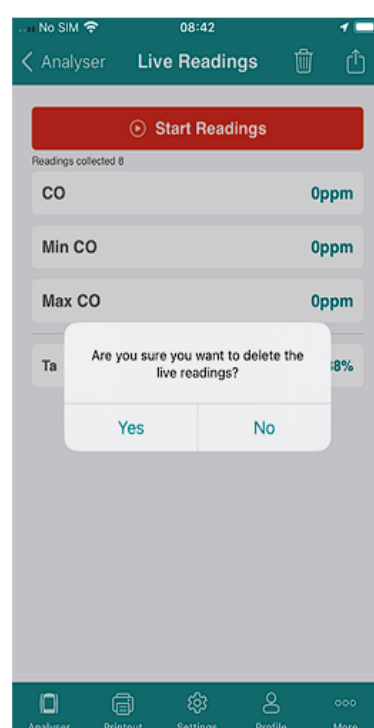


Pour effacer les lectures enregistrées à partir de l'application, appuyez sur l'icône de suppression dans la barre d'en-tête de l'application


⚠ AVERTISSEMENT :
les relevés enregistrés sont perdus si vous fermez ou déconnectez l'application avant de les partager ou de les enregistrer

5.4


DEMARRER L'ENREGISTREMENT IMMEDIAT

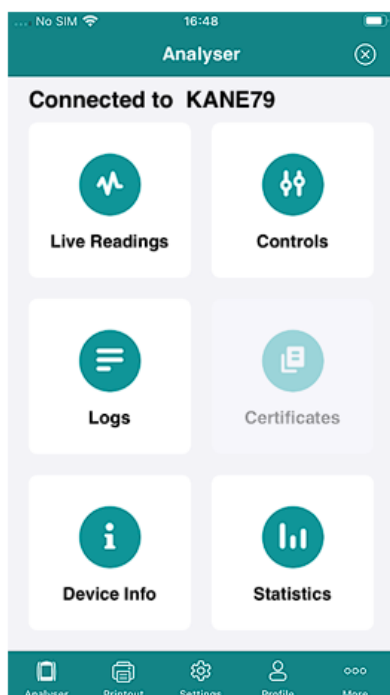


Appuyer sur Sauvegardes

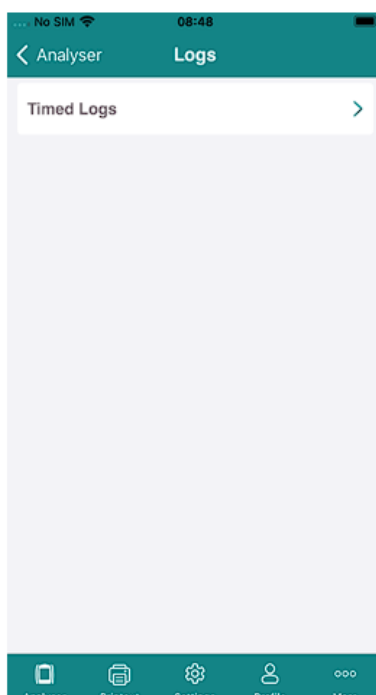


Appuyer sur **Timed Logs**

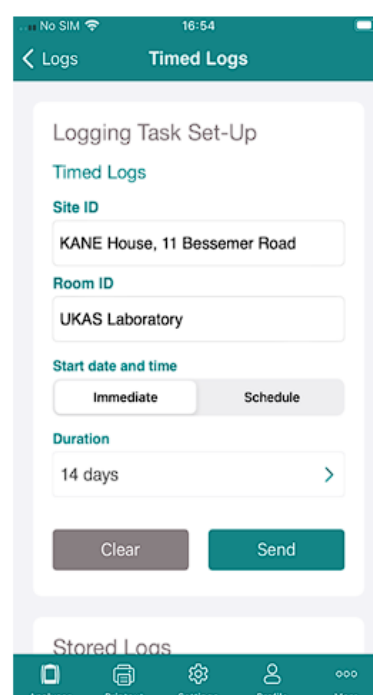


Saisissez l'ID du site et l'ID de la salle et appuyez sur Immédiat, sélectionnez la durée, puis appuyez sur Envoyer

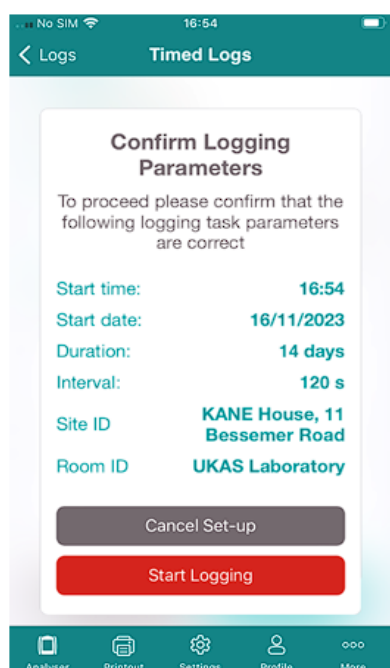

Appuyer sur **Start Logging**

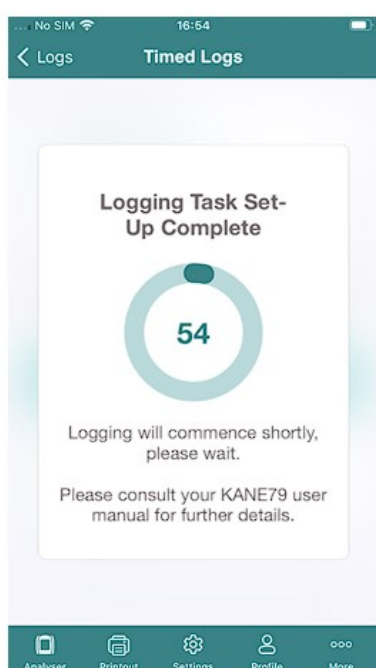


L'enregistrement démarre après un court décompte

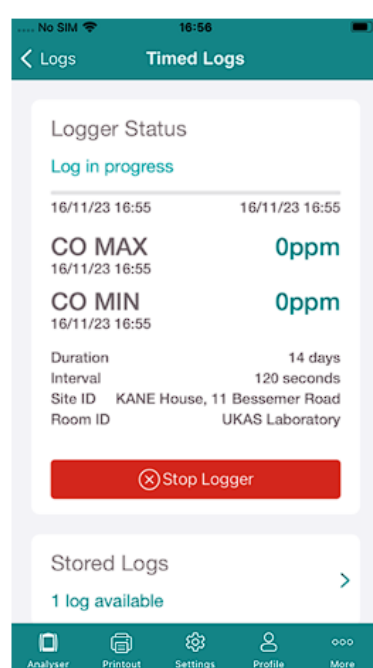


Consultez la progression actuelle et les relevés min et max de CO horodatés - déconnectez KANE79L de KANE LIVE

5.5


DEMARRER L'ENREGISTREMENT PROGRAMME

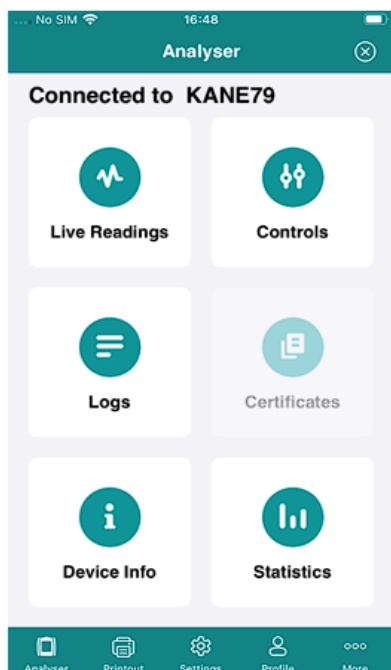


Appuyer sur Sauvegardes

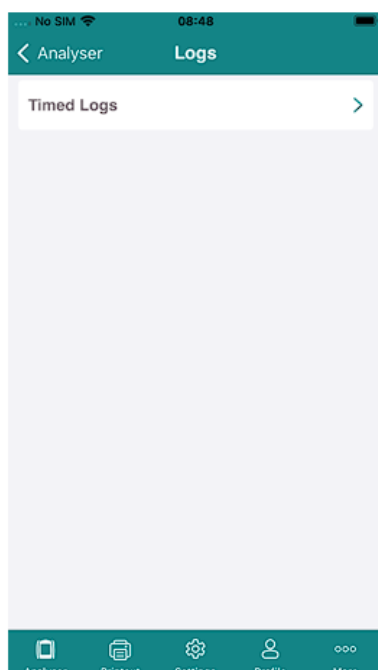


Appuyer sur **Timed Logs**

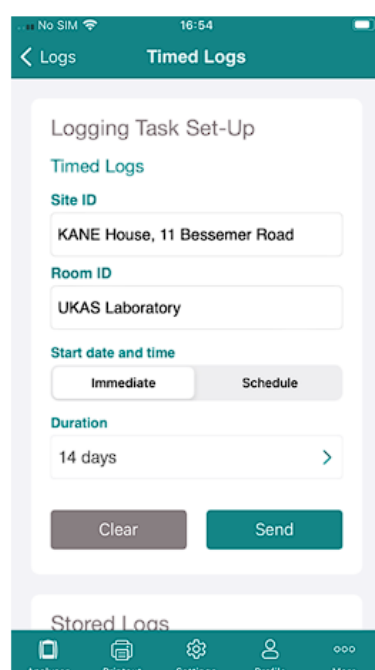


Saisissez l'ID du site et l'ID de la salle et appuyez sur Immédiat, sélectionnez la durée, puis appuyez sur Envoyer

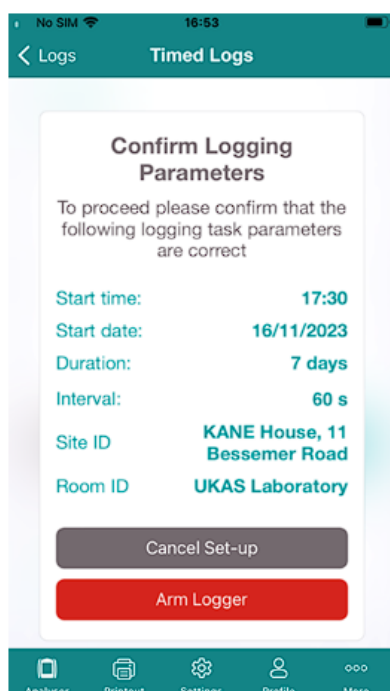

Appuyez sur Définir l'enregistreur pour planifier l'enregistrement

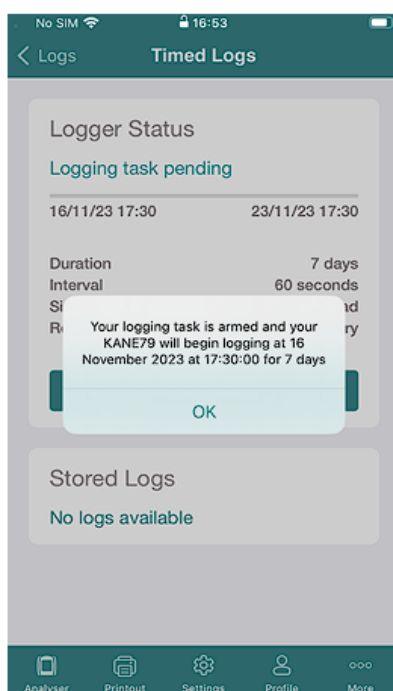


Confirmation que votre tâche est définie

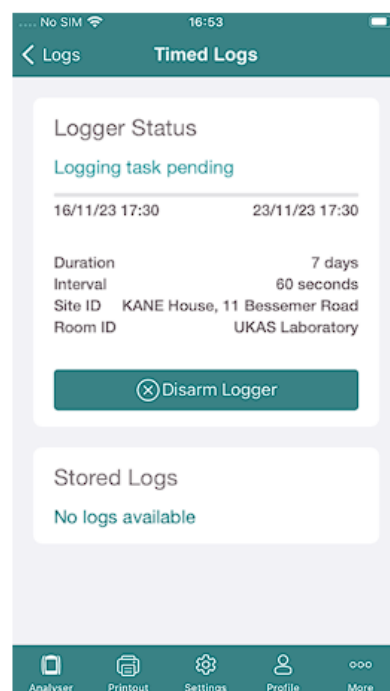


& en attente Déconnecter KANE79L de KANE LIVE

5.6


ARRETER L'ENREGISTREMENT PROGRAMME

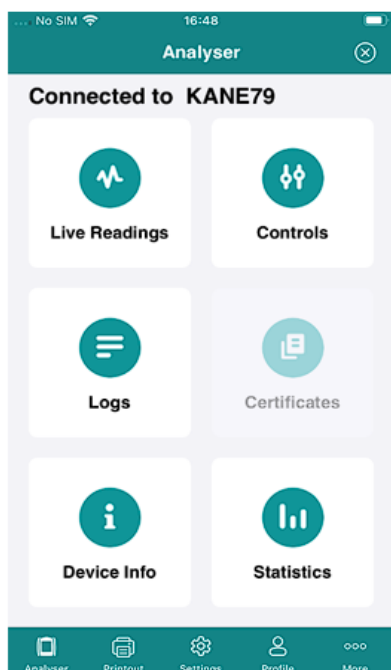


Appuyer sur Sauvegardes

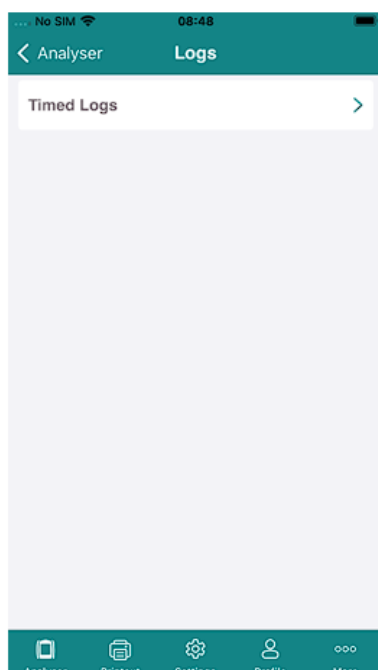

Appuyer sur **Timed Logs**

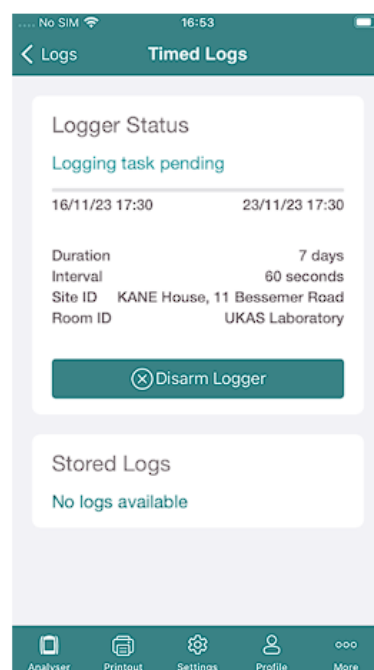


Appuyez sur Arrêter et confirmez

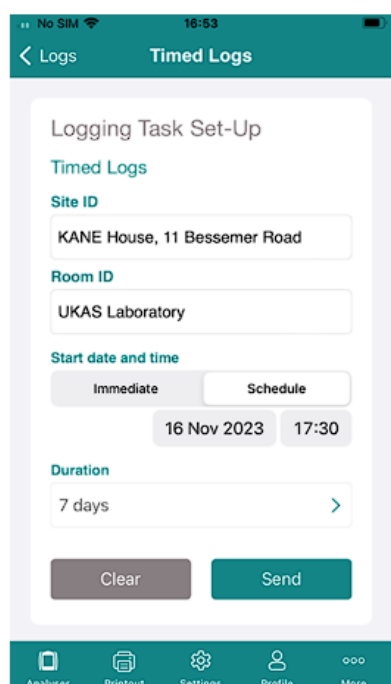



La tâche s'arrête et revient à la configuration

5.7

VISUALISER L'ETAT DE LA SAUVEGARDER EN

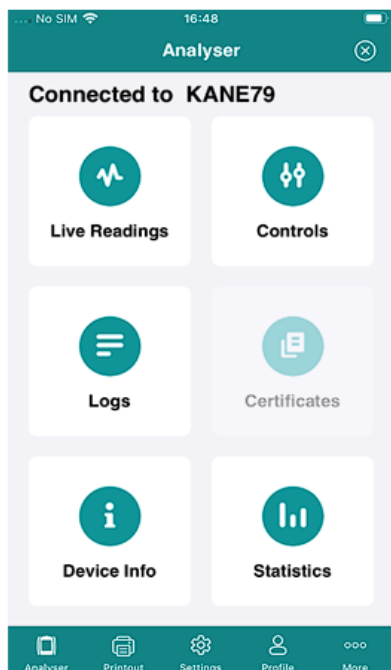


Appuyer sur Sauvegardes

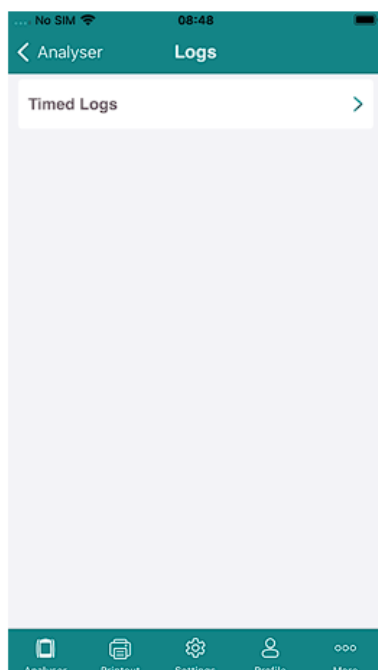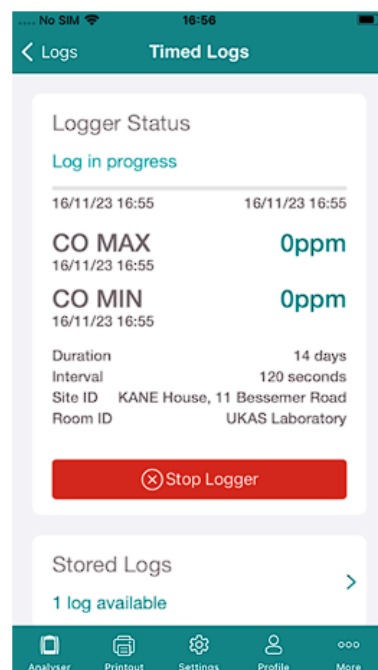
Appuyer sur **Timed Logs**

Visualisation du statut


5.8 ARRETER LA SAUVEGARDE EN COURS

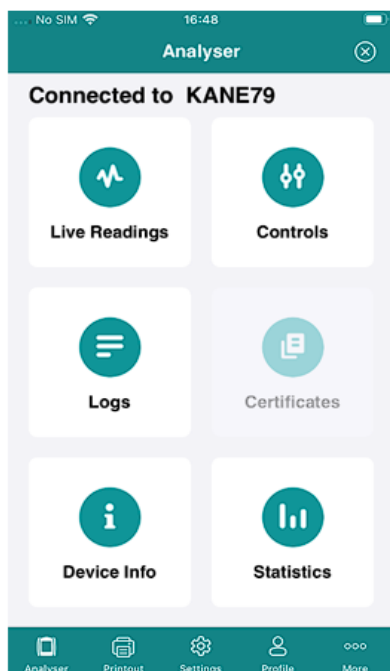


Appuyer sur Sauvegardes

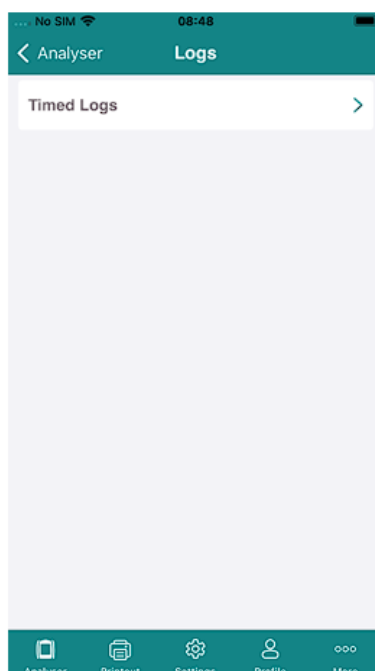

Appuyer sur **Timed Logs**

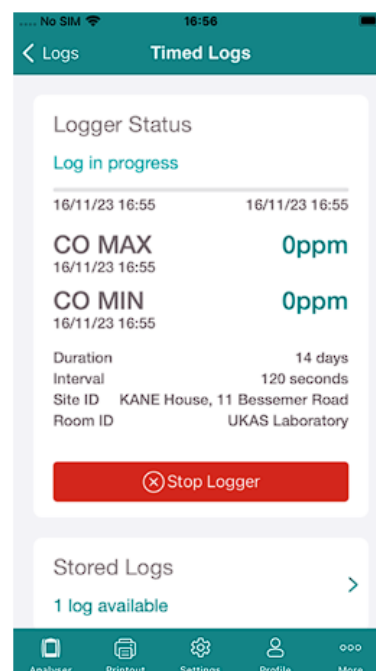


Appuyez sur Arrêter
l'enregistreur et confirmez

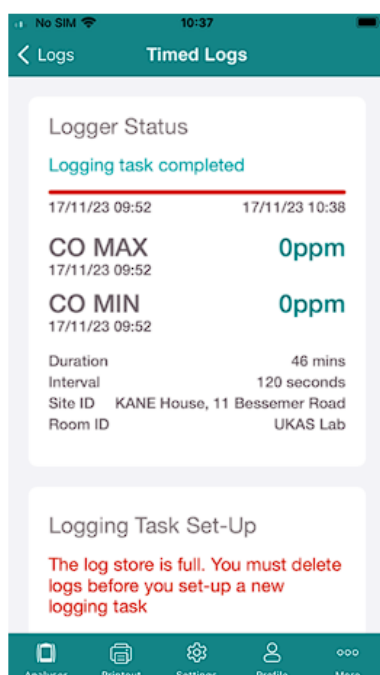


Appuyez sur Arrêter et
confirmez


5.9 DOWNLOAD TIMED LOGS

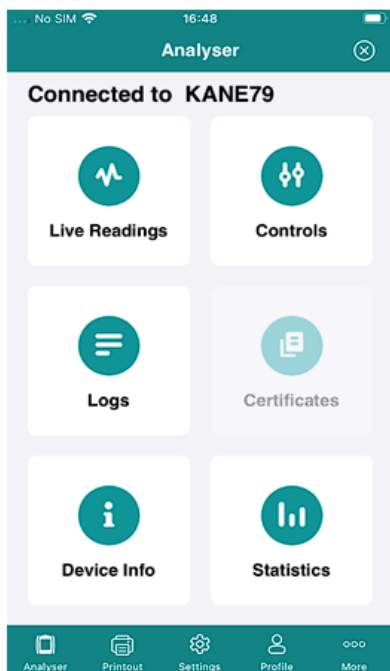


Appuyer sur Sauvegardes

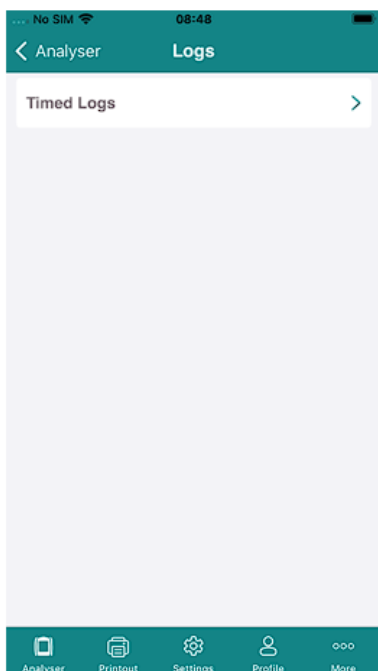


Appuyer sur **Timed Logs**

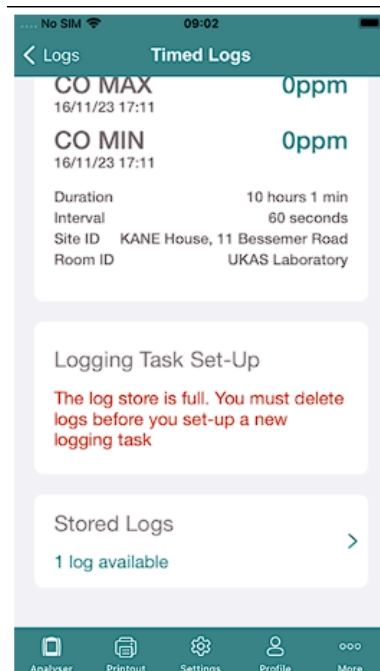


Faites défiler vers le bas et appuyez sur sauvegardes stockées

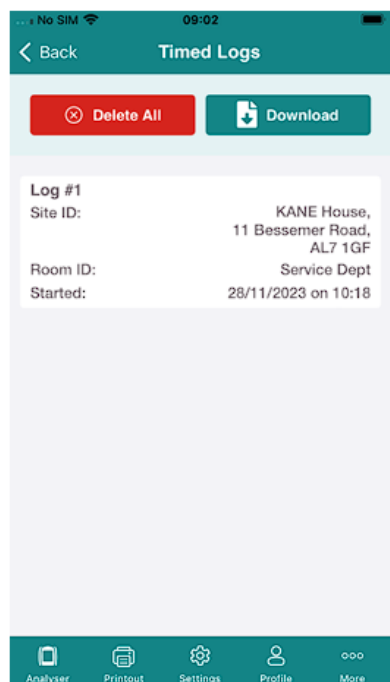

Appuyez sur Télécharger

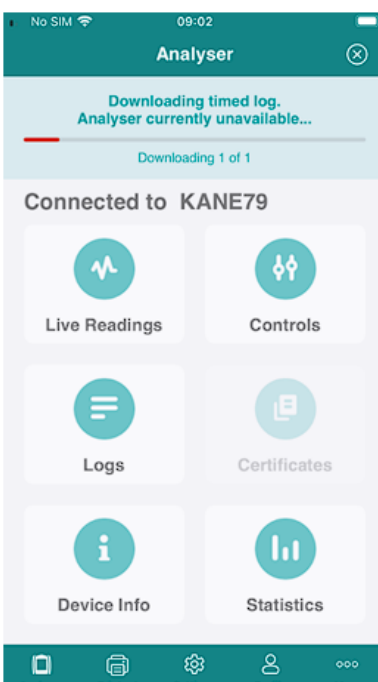


Si la sauvegarde contient beaucoup de données, le téléchargement peut prendre du temps

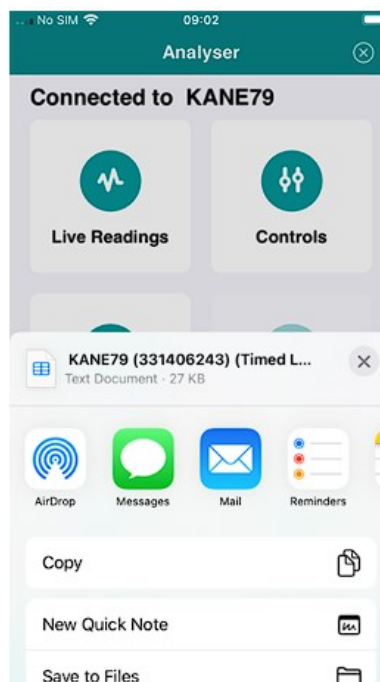


...Une fois le téléchargement terminé, enregistrez ou partagez les données au format *.csv.


5.10 DELETE TIMED LOG DATA

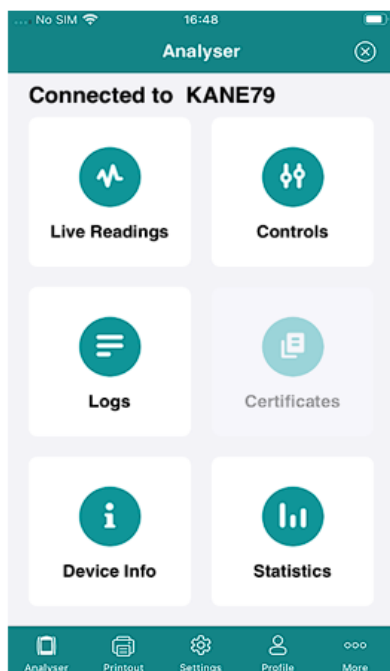


Appuyer sur Sauvegardes

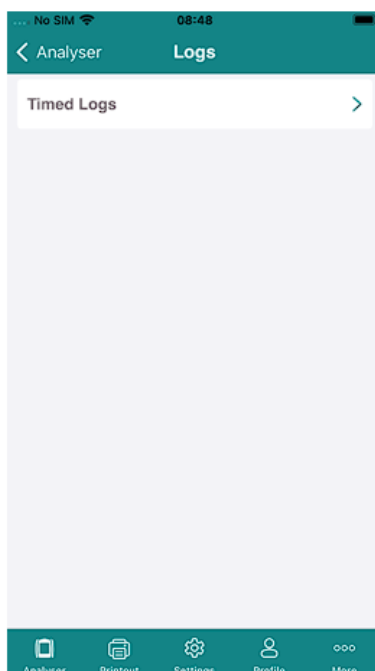


Appuyer sur **Timed Logs**

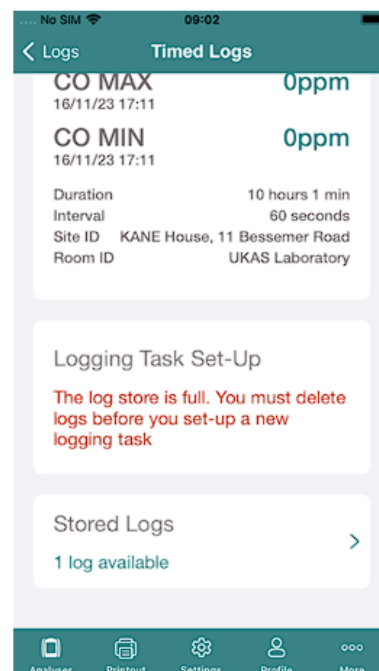


Faites défiler et appuyez sur les sauvegardes stockées

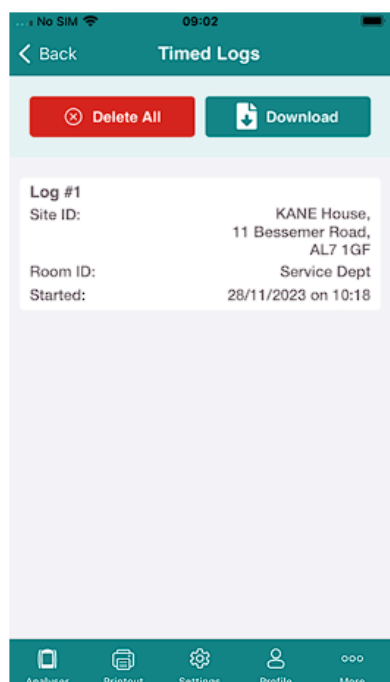

Appuyez sur Télécharger pour télécharger les sauvegardes stockées

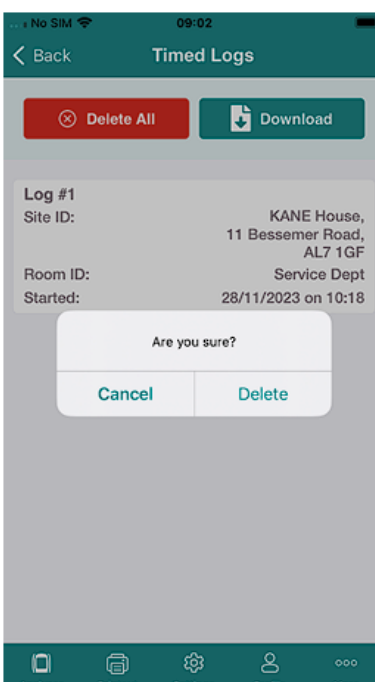

Confirmez que vous souhaitez supprimer toutes les sauvegardes

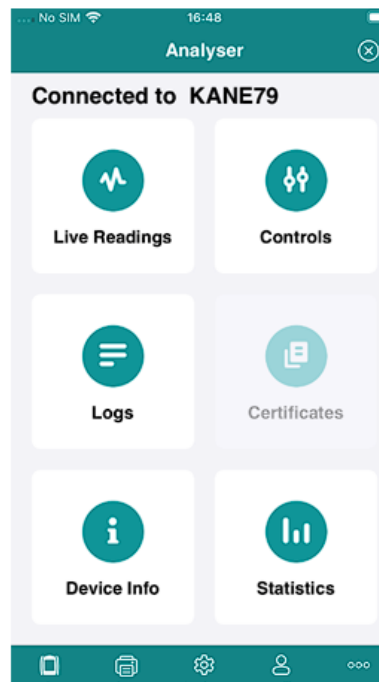

Retour à la page d'accueil de KANE LIVE

6

UTILISER KANE LINK POUR SE CONNECTER A L'ANALYSEUR

Allumer votre KANE79, active KANE LINK - Une liaison sans fil vers votre analyseur KANE LINK.

Vous pouvez connecter et afficher les lectures de jusqu'à 4 x KANE79 sur votre analyseur KANE LINK

1. Cela signifie que vous pouvez tester simultanément jusqu'à 4 pièces pour le CO tout en testant un appareil avec votre analyseur.
2. Appuyez et maintenez enfoncé MAX pendant 2 secondes pour ouvrir le MENU KANE79. Appuyez sur MAX ou HOLD pour sélectionner LINK puis appuyez une fois sur ON/OFF pour confirmer la sélection- voir section [5.1](#)
3. Conservez ce paramètre pour voir les lectures KANE79 affichées sur votre analyseur

Pour vous connecter, recherchez votre numéro de série KANE79 au dos du clip ceinture et préparez votre analyseur KANE LINK pour ajouter votre numéro de série KANE79.



Saisissez le numéro de série dans votre analyseur - une fois saisi, les relevés sont automatiquement envoyés dès qu'il est mis sous tension et connecté à votre analyseur.

NOTE :

Le numéro de série doit comporter 10 chiffres. S'il est plus court, saisissez des 0 pour atteindre 10.

Par exemple, saisissez le numéro de série J12345678 sous la forme 0012345678.

Ces valeurs sont basées sur des normes environnementales et sanitaires connues :

| Concentration de CO dans l'air | Temps d'inhalation et symptômes t'intoxication |
|---------------------------------------|--|
| 10ppm | Concentration maximale autorisée pour une période de 8 heures sans aucun risque connu pour la santé selon le ministère britannique de la santé et les normes britanniques BS7967 |
| 30ppm | Concentration maximale autorisée pour les personnes compétentes lors de l'enquête sur les rapports de fumées selon les Normes britanniques BS7967 |
| 200ppm | Légers maux de tête, fatigue, étourdissements et nausées après 2 à 3 heures |
| 400ppm | Maux de tête et nausées en 1 à 2 heures. Danger de mort après 3 heures |
| 800ppm | Maux de tête sévères, étourdissements et convulsions après 45 minutes. Perte de connaissance dans les 2 heures. Mort en 2 à 3 heures |
| 1,600ppm | Maux de tête, étourdissements et nausées dans les 20 minutes. Mort en 1 heure |
| 3,200ppm | Maux de tête, étourdissements et nausées dans les 5 à 10 minutes, Mort dans les 30 minutes |
| 6,200ppm | Maux de tête, étourdissements et nausées en 1 à 3 minutes. Décès dans les 10 à 15 minutes |
| 12,800ppm | Mort en 1 à 3 minutes |



ATTENTION !


Les effets varient en fonction de la taille, de l'âge, du sexe et de l'état de santé - nous ne sommes pas responsables de l'exactitude des informations.

ZÉRO CO dans l'air est votre objectif.


Votre KANE79 à 3 niveaux d'alarmes :

| Niveaux de CO | Indication |
|---------------|--|
| 2-9ppm | La LED verte clignote une fois toutes les 3 secondes |
| 10-19ppm | La LED rouge clignote une fois toutes les 2 secondes |
| > 20ppm | > 20ppm La LED rouge clignote une fois par seconde, son et vibrations actifs |

Indication Batterie pleine




Indication Batterie faible



Ne pas utiliser lorsque la batterie est faible/vide. Remplacez immédiatement la batterie.

Si les niveaux de batterie tombent à un niveau où la précision des lectures peut être compromise, le moniteur émettra un avertissement sonore et visuel avant de s'éteindre.


Indication d'alarme de batterie faible avant l'arrêt

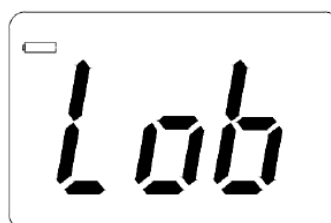


ATTENTION !

N'ignorez pas les avertissements car votre indicateur ne fonctionnera plus

Le compartiment à piles du KANE79 est situé sous le clip de ceinture. Pour accéder au compartiment des piles, le clip doit être tourné.

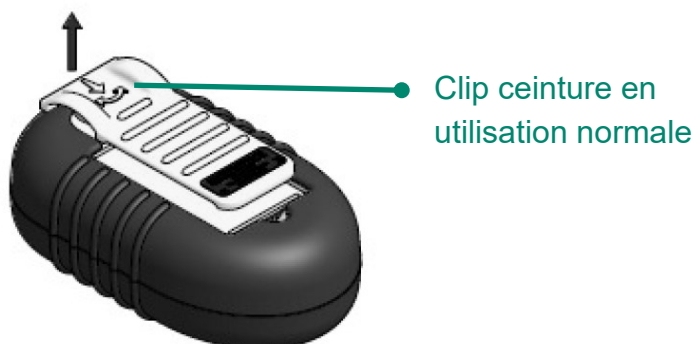

1. Soulevez le clip à l'extrémité du pivot contre le ressort de quelques millimètres, puis faites-le pivoter de 90 degrés pour dégager le compartiment à piles.

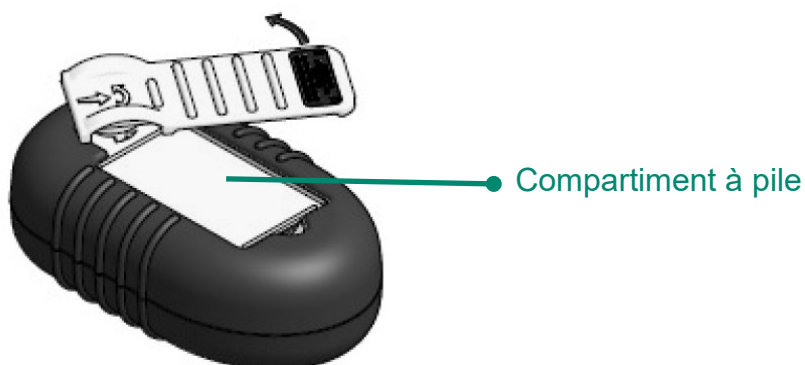

2. Retirez le couvercle du compartiment à piles et remplacez la pile - des piles alcalines à longue durée de vie sont recommandées.

Toujours recycler la batterie usée par le biais d'un programme de recyclage de batterie approuvé.

3. Après avoir installé une pile neuve, remplacez le couvercle et remettez le clip de ceinture dans sa position normale.



ATTENTION !

Vérifiez toujours le bon fonctionnement de votre indicateur après avoir remplacé la pile et calibrez-le toujours à zéro l'air frais extérieur.

Si l'affichage ne revient pas à zéro en quelques minutes, le capteur a atteint la fin de sa durée de vie ou a été exposé à des niveaux excessifs de CO.

Contactez KANE si cela persiste.

Vérifiez toujours le bon fonctionnement avant chaque utilisation.

Pour tester votre KANE79, utilisez une source connue de CO en prenant soin d'agir de manière sûre et de ne pas exposer le capteur à des températures ou à des concentrations de CO extrêmes.

Contactez KANE en cas de doute.

Si vous détectez du CO ambiant pendant l'utilisation, assurez-vous de savoir quelles mesures prendre pour vous protéger et protéger les autres.

Après utilisation, exposez toujours le détecteur à l'air frais jusqu'à ce que les mesures soient inférieures à 5 ppm, avant de l'éteindre.

Remarque : les mesures chutent lentement, vous devrez donc peut-être attendre quelques minutes.

| | |
|----------------------------|--|
| Gamme : | 0-999ppm |
| Résolution : | 1ppm |
| Précision : | ± 3 ppm 0 to 100ppm ¹ $\pm 5\%$ reading > 101ppm |
| Alarme sonore : | Voir page 11 |
| Indication visuelle : | LCD and LED |
| Batterie : | 3 x AAA piles alkaline |
| Autonomie de la batterie : | Jusqu'à 2 semaines d'enregistrement et jusqu'à 250 heures ² avec piles Duracell |
| Température ambiante : | 0-40°C (32-104°F) |
| Garantie : | 2 ans |

¹ Selon EN 50543 : 2011

² Basé sur une utilisation normale sans alarme.

NOTE:

Aucune pièce réparable par l'utilisateur.

Recalibrer tous les 12 mois.

Vérifiez le bon fonctionnement comme décrit dans ce manuel avant chaque utilisation.

Nettoyez ce détecteur avec un chiffon humide non pelucheux et une petite quantité de détergent non abrasif.

Évitez que l'humidité ne pénètre dans le couvercle du capteur et, après le nettoyage, laissez-le dans un endroit chaud et sec pour évaporer toute humidité de surface.

PRECAUTIONS PAR TEMPS FROID

Ne laissez pas votre détecteur dans un endroit froid pendant la nuit.

Les appareils électroniques qui refroidissent souffrent lorsqu'ils sont placés dans un endroit chaud. De la condensation peut se former, ce qui affecte les performances.

Les capteurs sont affectés par la condensation ou l'eau. Lorsque cela se produit, les lectures peuvent s'afficher comme « - » et les capteurs peuvent être endommagés de manière permanente.

Si votre détecteur est affecté par la condensation ou l'infiltration d'eau, laissez-le dans un endroit chaud pendant quelques heures.

Si vous rencontrez toujours des problèmes, veuillez contacter le service client de KANE.

OÙ ENVOYER VOTRE DETECTEUR

KANE International
123 rue Françoise Sagan
Ecopark du Raquet
59450 Sin le Noble France
Email : sav@kane.fr
Tél : +33(0)3 27 80 88 54

Cette déclaration de conformité est délivrée sous la seule responsabilité du fabricant :
Kane International Ltd.

Kane House, 11 Bessemer Road, Welwyn Garden City, Hertfordshire, AL10 1GF, UK. Tel:
+ 1707 375550 Web: www.kane.co.uk Le

KANE79 est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable ci-dessous :

| Directive UK | |
|--|--|
| Le Règlement sur la compatibilité électromagnétique 2016 (EMC) | |
| La restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les installations électriques | |
| Réglementation sur les équipements électroniques 2012 (RoHS) | |
| Règlement de 2016 sur les équipements électriques (sécurité) | |
| | |
| Directive EU | Titre |
| 2014/30/EU | Compatibilité électromagnétique (EMC) |
| 2011/65/EU | Restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (EMC) |
| 2014/35 | Directive basse tension (LVD) |

Les normes harmonisées et spécifications techniques suivantes ont été appliquées :

EMC
EN50270:2015

SAFETY
EN61010-1:2010

ROSH (UK & EU)
IEC62321-2:2013, IEC62321-1:2013, IEC62321-3-1:2013, IEC62321-5:2013,
IEC62321-4:2013, IEC62321-7-2:2017, IEC62321-7-1:2015, IEC62321-6:2015



Signé pour le compte de :-
01. December 2023

Kane International Ltd.

Paul Morrison
Engineering Manager

KANE79 MANUEL 29



BIENVENUE DANS KANE SÉRÉNITÉ

17

KANE SÉRÉNITÉ: nous serons toujours là pour vous soutenir

KANE SÉRÉNITÉ s'applique à tous les étalonnages des analyseurs série 258/358/458s/958 réservés en ligne via votre espace personnel KGP.

Pour plus d'informations, contactez-nous au 03 27 80 88 54 ou par mail à l'adresse: infos@kane.fr

Utilisez les 11 chiffres

18262020092



- ★ **Enregistrez** votre analyseur sur notre site et téléchargez son manuel d'utilisation via votre espace KGP.
- ★ **VEUILLEZ LIRE TOUS LES AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ DU MANUEL**
- ★ Utilisez notre site pour gérer vos analyseurs, acheter des pièces détachées, des consommables ou d'autres produits KANE
- ★ Retrouvez notre FAQ sur notre site ou sur notre chaîne YouTube
- ★ Une question ? Appelez notre équipe au 03 27 80 88 54 de 8H à 17H30 du lundi au vendredi

Plus d'informations: www.kane.fr/service-apres-vente
www.kane.fr





LES ENGAGEMENTS “KANE SÉRÉNITÉ”

- ★ 10 ans de garantie pour les analyseurs révisés annuellement
- ★ Prise en charge des frais d'envoi « aller/retour »
- ★ Révision effectuée dans les 24h
(hors remplacement de cellules - 48h avec remplacement de cellules)
- ★ Retour de votre appareil dès le lendemain
(si réception avant 10H chez KANE)
- ★ Réduction de 50%* sur l'achat d'un nouvel analyseur en cas de vol
De votre analyseur (dépôt de plainte obligatoire mentionnant le numéro de série)



L'offre KANE SÉRÉNITÉ s'applique à tous les étalonnages des analyseurs série 158/258/358/458s/460 réservés en ligne via votre espace personnel KGP

Pour plus d'informations, contactez-nous au **03 27 80 88 54**

LES ENGAGEMENTS “KANE SÉRÉNITÉ+”

Achetez un pack comprenant l'entretien complet de votre analyseur sur 5 ans série 158/258/358/458s/460 et économisez de l'argent, offrez-vous 5 ans de protection, avec tous les avantages de KANE SÉRÉNITÉ plus:

- ★ Protection contre le vol - une première dans l'industrie - en cas de vol. nous remplaçons votre analyseur KANE gratuitement*
- ★ 10% d'économie sur les révisions de votre série 158/258/358/458s/460
- ★ Ayez l'esprit tranquille pour centimes par jour
- ★ Uniquement disponible auprès des distributeurs agréés KANE
- ★ Activation sécurisée via votre

Pour plus d'informations, contactez-nous au **03 27 80 88 54**

KANE5SP

572€HT**

*(nécessite un dépôt de plainte mentionnant le numéro de série)

**Tarif valable pour une configuration standard (CO + O2 ou CO2)







Procédure Retour Sav - Revision Garantie Sous 24h



Enregistrez votre analyseur sur
www.kane.fr

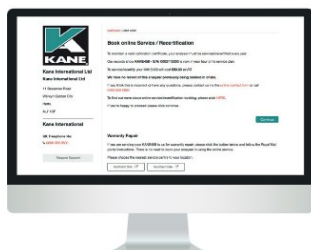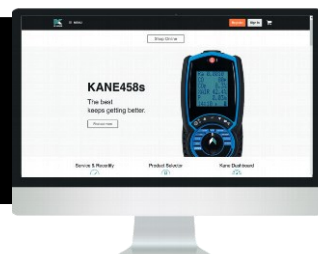

Réservez et payez votre prestation SAV
via votre espace personnel KGP

Recevez votre bon de prise en
charge du transport à coller sur le



Votre analyseur est renvoyé sous 24h (hors
remplacement de cellules) OU NOUS
VOUS REMBOURSONS

*Hors KANE-EGA, AUTO600, "séries 9" & certification UKAS




Demande d'informations



Envoyez un mail à infos@kane.fr, indiquez votre type d'analyseur et son numéro de

Payez votre devis en ligne

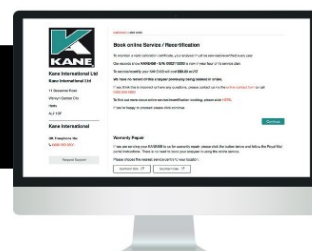

Retournez votre analyseur et ses accessoires

Nous vous retournerons votre matériel gratuitement* après sa révision avec un an de



*Hors taxes locales et frais



Welcome to KANE & UKAS



18 KANE & UKAS CERTIFICATION - ISO 17025:2017

- ★ L'accréditation UKAS est la norme d'approbation la plus élevée qu'un fournisseur de tests et de mesures puisse atteindre - Elle confirme que son laboratoire de certification fonctionne selon les normes de compétence et d'impartialité les plus élevées UKAS is the only recognized UK authority assessing laboratory standards & capability
- ★ UKAS est la seule autorité britannique reconnue évaluant les normes et les capacités des laboratoires
- ★ KANE est le seul fabricant d'analyseurs de gaz de combustion accrédité par UKAS selon la norme ISO 17025:2017 pour la certification des gaz
- ★ Les certificats d'étalonnage UKAS de KANE sont des documents juridiques que vous pouvez soumettre comme preuve à un tribunal britannique - ils prouvent que votre analyseur a été certifié selon la norme la plus élevée possible
- ★ Commandez une certification UKAS à prix fixe à tout moment - prévoyez un délai de 7 jours pour renvoyer votre analyseur pour le service et la recertification KANE CARE



Une question ? E-mail : infos@kane.rf



Plus d'information au 03 27 8 88 54



CE PRODUITS EST CONFORME A :



VEUILLEZ RECYCLER - CONTACTEZ-NOUS

EMBALLAGE FABRIQUÉ AU ROYAUME-UNI

Merci d'avoir acheté cet analyseur.

Avant utilisation, veuillez-vous inscrire sur notre site Web



www.kane.fr

Scanner ce QR code pour aller directement
enregistrer votre produit en ligne.

Kane International LTD
123 rue Françoise Sagan
Ecopark du Raquet
59450 Sin le Noble
Courriel : infos@kane.fr
Téléphone : 03 27 80 88 54

Stock No: MAN00584 REV.1